Этикетка

КЕНОТРОН ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КРМ-150

Высоковольтный кенотрон КРМ-150 с вольфрамовым катодом, предназначен для работы в масле в выпрямительных устройствах рентгеновских аппаратов широкого применения.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫВОДАМИ

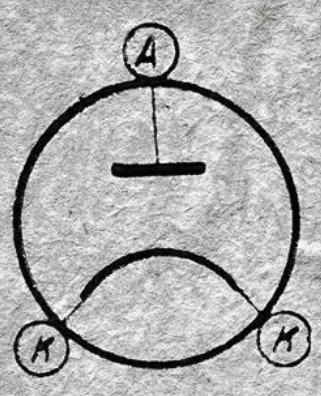

Обозначение выводов	Наименование электродов
А (верхний вывод)	Анод
К, К	Катод

Основные электрические данные

Напряжение накала, *В* . . . . . 12,5±0,5
Ток накала, *А*, не более 9
Ток эмиссии катода *, *мА*, не менее 300
Гарантийная наработка, *ч* 600

* При напряжении накала 13 *В*, напряжении анода кенотрона 3 *кВ*.

Допустимые режимы эксплуатации

Напряжение накала, *В*, не менее 12
не более 13
Амплитуда обратного напряжения при работе кенотрона в масле, *кВ*, не более 150
Среднее значение выпрямленного тока, *мА*, не более:
— при длительности включения 0,1 *с* 150
— при длительности включения 1 *с* 125
— при длительной работе (при этом кенотрон может работать непрерывно в течение всего времени гарантийной наработки) 30

Примечания: 1. Значение амплитуды обратного напряжения и выпрямленного тока указаны для эксплуатации кенотронов в бесконденсаторных схемах с однополупериодным выпрямлением.

2. В схемах удваивания с постоянным напряжением амплитуды обратного напряжения на кенотроне не более 135 *кВ*.

3. В бесконденсаторных схемах с двухполупериодным выпрямлением среднее значение выпрямленного тока должно быть снижено на 30%.

Указания по эксплуатации

Указания по эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации.
Габаритные размеры:
Наибольшая высота, *мм* 405
Наибольший диаметр, *мм* 105
Драгоценных металлов не содержится.
Технические условия ОД0.339.123 ТУ.

ППО № 1-6 Ленуприздата з. 3006 т. 1200 20.04.77